

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Приборы энергетика однофазные НЕВА-Тест 7203

#### Назначение средства измерений

Приборы энергетика однофазные НЕВА-Тест 7203 (далее – приборы) предназначены для измерения и регистрации основных параметров электрической энергии в однофазных электрических сетях:

- действующих значений напряжения и тока при синусоидальной и искаженной формах кривых; активной, реактивной и полной электрической мощности;
- проверки однофазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, а также для контроля метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей.

#### Описание средства измерений

Принцип действия прибора основан на аналого-цифровом преобразовании мгновенных значений гармонических входных сигналов, с последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии со встроенным программным обеспечением (ПО). Прибор обеспечивает автоматическую диагностику. Архивирование результатов измерений производится во внутренней памяти прибора. Прибор имеет в своем составе последовательный интерфейс для передачи информации во внешние устройства.

Конструктивно прибор выполнен в едином корпусе с токовыми клещами (ТК). Корпус выполнен из ABS пластика. На лицевой панели прибора расположены сенсорный экран с разрешением 320×240 пикселей и кнопка включения питания. Управление прибором осуществляется с помощью виртуальных кнопок на сенсорном экране.

Питание прибора осуществляется либо от внешнего источника питания, через адаптер питания, либо от внутреннего аккумулятора.

Прибор обеспечивает индикацию на ЖКИ и регистрацию с последующей передачей на персональный компьютер (ПК) результатов измерения значений параметров электрической сети.

Область применения приборов:

- энергетическое обследование предприятий потребителей электрической энергии (энергоаудит);
- наладка и испытания систем электроснабжения;
- комплектация метрологических лабораторий (в том числе передвижных).

Приборы могут быть использованы автономно и в сочетании с персональным компьютером (ПК), расширяющим их функциональные возможности.

Внешний вид прибора и места пломбирования представлены на рисунке 1.

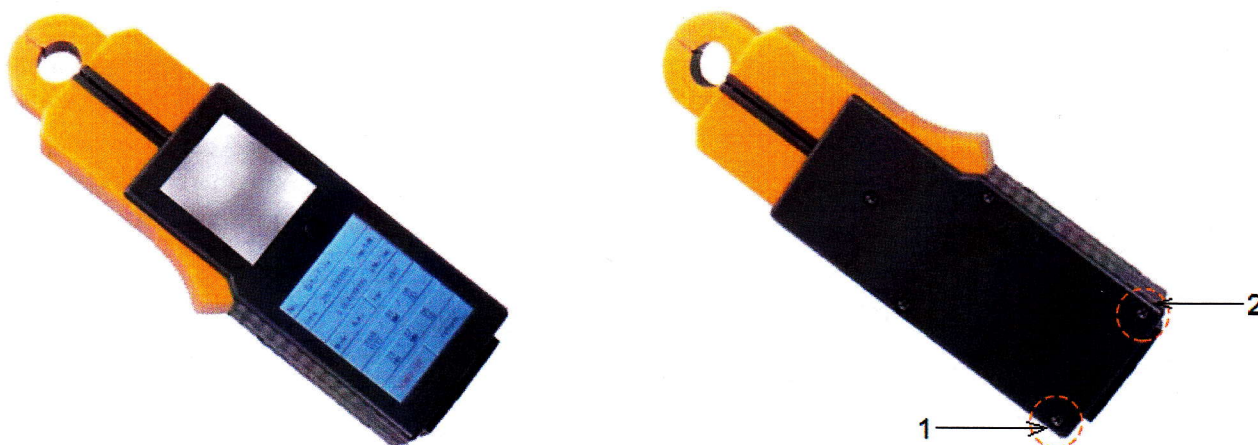


Рисунок 1

Пломбирование приборов после поверки осуществляется организацией, осуществляющей поверку. Пломба поверителя наносится в позиции 1 на рисунке 1, пломба производителя наносится в позиции 2 на рисунке 1. Обе пломбы наносятся либо способом давления на пломбу (специальную мастику), либо в виде наклеек, соответствующих действующему законодательству в области обеспечения единства измерений, и предотвращают доступ к элементам конструкции и местам регулировки прибора.

### Программное обеспечение

В комплекте с прибором для отображения параметров на ПК поставляется программное обеспечение (ПО) верхнего уровня. Метрологически значимых частей внешнее ПО не содержит.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Встроенное ПО НЕВА-Тест 7203
Номер версии (идентификационный номер ПО)	HV: не ниже 2.8 SV: не ниже 10.0.100 EN
Цифровой идентификатор ПО	753C
Другие идентификационные данные (если имеются)	-

Уровень защиты программного обеспечения прибора от непреднамеренных и преднамеренных изменений высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Основные технические и метрологические характеристики приборов приведены в таблицах 2 и 3.



Таблица 2

Измеряемые параметры электрической энергии	Диапазоны измерений	Пределы и вид допускаемой основной погрешности	Примечание
1. Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения, В	от 15 до 265	относительная $\pm 0,5 \%$	
2. Действующее (среднеквадратическое) значение переменного тока, А	от 0,005 до 100	относительная $\pm 0,5 \%$ $\pm 5,0 \%$	$0,05 \text{ A} < I \leq 100 \text{ A}$ $0,01 \text{ A} \leq I \leq 0,05 \text{ A}$
3. Частота переменного тока, Гц	от 45 до 65	абсолютная $\pm 0,05$	
4. Фазовый угол между фазными напряжением и током первых гармоник, градус	от - 180 до + 180	абсолютная $\pm 0,5$ $\pm 1,5$	$0,2 \text{ A} \leq I \leq 100 \text{ A}$ $0,05 \text{ A} \leq I < 0,2 \text{ A}$
5. Коэффициент мощности	от -1,0 до +1,0	абсолютная $\pm 0,005$	$0,05 \text{ A} \leq I \leq 100 \text{ A}$
6. Активная электрическая мощность и энергия, Вт	от 0,15 до 26500	относительная $\pm 0,5 \%$ $\pm 1,0 \%$	$0,1 \text{ A} < I \leq 100 \text{ A}$ Кр* от 0,25L до 0,5C $0,05 \text{ A} \leq I \leq 0,1 \text{ A}$ Кр = 1
7. Реактивная электрическая мощность и энергия, вар	от 0,15 до 26500	относительная $\pm 0,5 \%$ $\pm 1,0 \%$	$0,5 \text{ A} \leq I \leq 100 \text{ A}$ Кр от 0,5L до 0,5C $0,1 \text{ A} \leq I < 0,5 \text{ A}$ Кр = 1

\* Примечание: Кр – коэффициент мощности.

Пределы допускаемых дополнительных погрешностей, вызываемых изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям приведены в таблице 3.

Таблица 3

Влияющая величина	Пределы допускаемой дополнительной погрешности
Изменение частоты	относительная $< \pm 0,2 \%$
Температурный коэффициент, не более	$\pm 0,03 \%/^{\circ}\text{C}$
Гармоники в цепях тока и напряжения	относительная $< \pm 0,5 \%$

Общие технические характеристики Приборов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика	Значение
Напряжение питания постоянного тока	2,4 В
Потребляемая мощность, не более, В·А	5
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), не более, мм	230 × 70 × 35
Масса, не более, кг	0,4
Среднее время наработки на отказ, не менее, ч	90 000
Средний срок службы, не менее, лет	8

Прибор обеспечивает приведенные метрологические характеристики по истечении времени установления рабочего режима не более 15 минут.

Рабочие условия эксплуатации прибора:

Температура окружающего воздуха, °С

Относительная влажность воздуха, %

Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

от минус 10 до 45;

до 85 при 25°С;

от 84 до 106,7 (630–800).

#### Знак утверждения типа

наносится на титульных листах эксплуатационной документации типографским способом и на щитке, закрепленном на корпусе прибора.

#### Комплектность средства измерений

Комплектность приборов энергетика однофазных НЕВА-Тест 7203 приведена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Обозначение	Кол-во
Прибор энергетика однофазный НЕВА-Тест 7203	ТАСВ.411722.010	1 шт.
Комплект кабелей		1 компл.
Оптическая головка		1 шт.
Руководство по эксплуатации	ТАСВ.411722.010	1 экз.
Кейс для переноса и хранения		1 шт.
Дополнительные принадлежности*:		
Программное обеспечение НЕВА-Тест 7203		1 диск
Методика поверки	ТАСВ.411722.010	1 экз.

\* Дополнительные принадлежности поставляются в соответствии с договором поставки.

#### Поверка

осуществляется по документу ТАСВ.411722.010 МП "Приборы энергетика однофазные НЕВА-Тест 7203. Методика поверки", утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в ноябре 2015 г.

Основные средства поверки:

- установка автоматическая трёхфазная для поверки счётчиков электроэнергии НЕВА-Тест 3303Л класса точности 0,05: погрешность измерения тока:  $\pm 0,1$  в диапазоне от 50 мА до 100 А,  $\pm 0,2$  в диапазоне от 10 мА до 50 мА, погрешность измерения напряжения  $\pm 0,1$  в диапазоне от 10 В до 250 В, погрешность измерения активной мощности  $\pm 0,05$  в диапазоне токов от 0,05 до 100 А,  $\pm 0,1$  в диапазоне токов от 0,01 до 0,05 А;



- установка для проверки электрической безопасности GPI-725A: испытательное постоянное напряжение 50В, 100 В, 500 В, 1000 В, диапазон измерений от 1МОм до 10 ГОм, относительная погрешность (в диапазоне от 1МОм до 50 МОм)  $\pm 0,05 R_{\text{инд}}$ ;
- осциллограф универсальный С1-137 (С1 – 99): полоса пропускания  $> 1$  МГц,  $U_{\text{ВХ}}$  от 0.01 до 5 В/дел.,  $R_{\text{ВХ}} \geq 1$  МОм,  $C_{\text{ВХ}} \leq 50$  пФ.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений изложена в Руководстве по эксплуатации "Приборы энергетика однофазные НЕВА-Тест 7203. Руководство по эксплуатации ТАСВ.411722.010 РЭ".

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам энергетика однофазным НЕВА-Тест 7203**

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

Технические условия «Приборы энергетика однофазные НЕВА-Тест 7203. ТАСВ.411722.010 ТУ».

**Изготовитель**

ООО «Тайпит - Измерительные приборы» (ООО «Тайпит - ИП»), г. Санкт Петербург  
ИНН 7811472920

Адрес: 193318, Россия, г. Санкт – Петербург, ул. Ворошилова, д.2  
Тел./факс: (812) 326-1090 / (812) 325-5864

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

«24»

02

2016 г.



ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
5/нео ЛИСТОВ(А)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CC Тольку

2018